

**Opolskie Centrum Rehabilitacji
Wyzwolenia 11
48-317 Korfantów**

Pismo: PZP-225/02/2015/3

Korfantów dnia:14.01.2015 r.

ODPOWIEDZ na zapytania w sprawie SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **"Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji"**

Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.

1. Dotyczy Pakietu nr 9, pozycja nr 6: Czy Zamawiający dopuści metkownicę trzyrzędową numeryczną typu BLITZ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Oferowana metkownica musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie ma prawa wskazywać na producenta urządzenia oraz typ czy model.

2. Dotyczy Pakietu nr 9, pozycja nr 7: Czy Zamawiający dopuści etykiety w jednym kolorze: białym kompatybilne z metkownica trzyrzędową typu BLITZ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zaoferowane etykiety muszą być kompatybilne z ferowaną metkownicą i spełniać opisane wymagania i właściwości. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie etykiet tylko w jednym kolorze przy zachowaniu pozostałym opisanych parametrów.

3. Dotyczy Pakietu nr 9, pozycja nr 7: Czy Zamawiający dopuści etykiety w rolkach po 500 sztuk? Wielkości zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona tj. 4 komplety po 18 (500 sztuk etykiet na rolce) + 1 rolka tuszująca do każdego kompletu.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający dopuszcza.

4. Dotyczy Pakietu nr 9, pozycja nr 6-7: W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytania uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanych pozycji do oddzielnego pakietu. Podział umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej licznie Wykonawców.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wydzieli do osobnego pakietu wskazanych pozycji.

5. Dotyczy pakietu nr XI poz. 1 i 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 i 2 fartuchów o gramaturze 35gm/2?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, zgodnie z SIWZ.

6. Dotyczy pakietu nr XI poz. 3 i 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 i 4 fartuchów o gramaturze 35g/2 w części podstawowej i + 50g/m2 w części wzmocnionej?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, zgodnie z SIWZ.


7. dotyczy pakietu nr XI poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 5 ubrań operacyjnych w rozmiarach S-XL pakowanych oddzielnie (osobno bluza i osobno spodnie), co w dużej mierze ułatwia dobór odpowiedniego rozmiaru

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający dopuszcza.

8. dotyczy pakietu nr XII poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w składzie:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 1 serweta 100 x 150cm
- 1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z warstwą chłonną 15 x 50 cm i organizatorami przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni + łąta chłonna)
- 1 osłona na nogę 36 x 120 cm
- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta 230 x 260 cm, z wycięciem „U” 20 x 85 cm, z warstwą chłonną 50x100cm, z organizatorami przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni + łąta chłonna)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

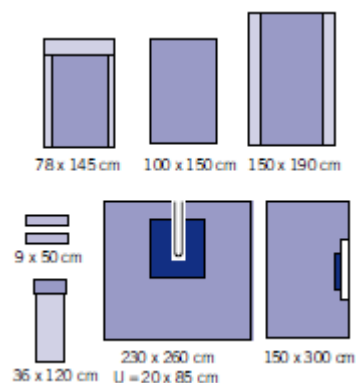


Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, zgodnie z SIWZ.

9. dotyczy pakietu nr XII poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w składzie:

- 1 taśma mocująca 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo
- 4 ręczniki do rąk 30,x32cm
- 2 przylepne serwety 75 x 90 cm z warstwą chłonną 25x60cm (3-warstwowe na całej powierzchni + łąta chłonna)
- 1 przylepna serweta średnia 180 x 180 cm z warstwą chłonną 25x60cm i organizatorami przewodów (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta, wymiar 3w 75x180cm + łąta chłonna)
- 1 przylepna serweta duża 150 x 240 cm z warstwą chłonną 25x60cm i organizatorami przewodów (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta, wymiar 3w 75x240cm + łąta chłonna)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

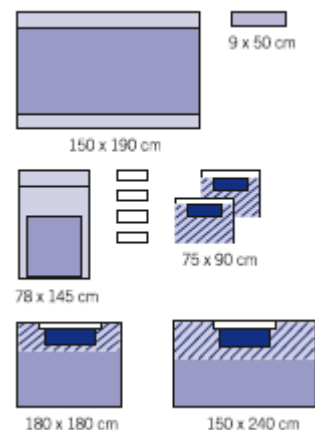


Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, zgodnie z SIWZ.


10. dotyczy pakietu nr XII poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w składzie:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo
- 4 ręczniki do rąk
- 1 taśma mocująca 9x50cm
- 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5cm, z warstwą chłonną 75 x 80 cm i organizatorami przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni + łąta chłonna)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

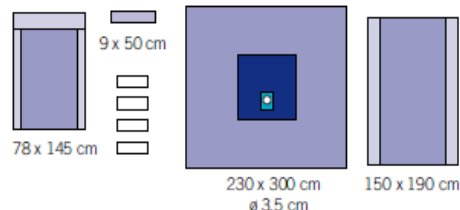

LUB

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 4 ręczniki do rąk
- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium składana 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

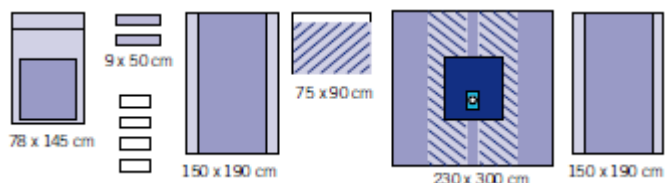


- 1 serweta przylepna 75 x 90 cm (3-warstwowa na całej powierzchni)
- 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm, z elastycznym otworem o średnicy 7cm z warstwą chłonną 50 x 100 cm, z organizatorami przewodów (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łąta chłonna)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, zgodnie z SIWZ.

11. dotyczy pakietu nr XII poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w składzie:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 4 ręczniki do rąk
- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium składana 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
- 1 elastyczna osłona na nogę 22 x 75 cm
- 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm, z elastycznym otworem o średnicy 7cm z warstwą chłonną 50 x 100 cm, z organizatorami przewodów (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łąta chłonna)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

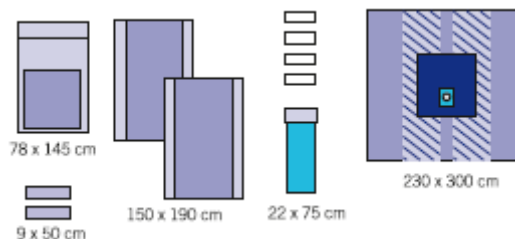


Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, zgodnie z SIWZ.

12. dotyczy pakietu nr XII poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w składzie:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 4 ręczniki do rąk
- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
- 1 elastyczna pończocha 22 x 75 cm
- 1 serweta do artroskopii z torebką na płyny 230 x 320 cm (torba na płyny trójkątna o wymiarach 105cm każdy bok) i z 2 elastycznymi otworami o średnicy 5cm + filtr i port do odsysania (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

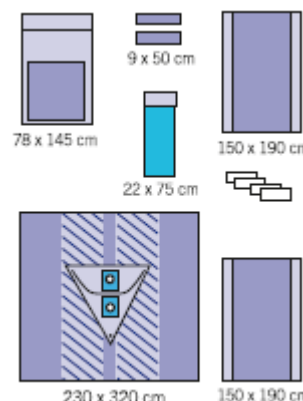

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, zgodnie z SIWZ.

13. dotyczy pakietu nr XII poz. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 60g/m2 z otworem 6x8cm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

dotyczy pakietu nr XII: Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu udokumentowania stawianego w SIWZ w postaci zdolności absorpcyjnej, mającej stanowić powyżej min. 440% (materiał bazowy) i 900% (obszar wzmocniony). Po pierwsze konieczność badania tych parametrów nie została określona w żadnej z obowiązujących z norm, a po drugie Zamawiający nie określił czego absorpcja ta ma dotyczyć – wody, krwi czy innych płynów. W stawianych w SIWZ wymaganiach wskazują Państwo na konieczność zaoferowania produktów zgodnych z normą EN 13795-1-3. Norma ta w żaden sposób nie nakłada obowiązku badania absorpcyjności w %. Informacja o odporności na penetrację płynów, stanowi wystarczającą (wg obowiązujących norm) informację określającą absorpcję serwet.

W związku z powyższym wnosimy jak wyżej o odstąpienie od wykazania spełnienia w/w wymogu.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający nie będzie wymagał udokumentowania określonej absorpcji serwet

Dotyczy Pakietu Nr XII

14. Czy Zamawiający dopuści, aby w poz. 1 zaoferowano zestaw do operacji biodra spełniający wszystkie wymagania obowiązującej normy PN EN 13795 1-3 w składzie:

| | | |
|---|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów | 300x175 | 1 |
| 2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem "U" o wymiarach 7x102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej | 200x260 | 1 |
| 3. serweta chirurgiczna | 75x90 | 1 |
| 4. serweta na stół | 150x190 | 1 |
| 5. osłona na kończynę | 32x120 | 1 |
| 6. taśmy samoprzylepne | 9x49 | 2 |
| 7. ręczniki chłonne | 18x25 | 4 |
| 8. wzmocniona osłona na stół Mayo | 79x145 | 1 |
| 9. wzmocniona serweta na stół - (owinięcie zestawu) | 150x190 | 1 |

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, zgodnie z SIWZ.

15. Czy Zamawiający dopuści, aby w poz. 2 zaoferowano wzmocniony, czterowarstwowy zestaw uniwersalny spełniający wszystkie wymagania obowiązującej normy PN EN 13795 1-3 w składzie:

| | | |
|--|---------|---|
| 1. serweta górna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów | 240x150 | 1 |
| 2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej | 90x75 | 2 |
| 3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów | 175x175 | 1 |
| 4. taśma samoprzylepna | 9x49 | 1 |
| 5. ręczniki chłonne | 18x25 | 4 |
| 6. osłona na stół MAYO | 79x145 | 1 |
| 7. serweta na stół - (owinięcie zestawu) | 150x190 | 1 |

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, zgodnie z SIWZ.

16. Czy Zamawiający dopuści, aby w poz. 3 zaoferowano wzmocniony, zestaw do operacji dłoni/stopy spełniający wszystkie wymagania obowiązującej normy PN EN 13795 1-3 w składzie:

| | | |
|---|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna do zabiegu na kończynie o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór (Ø 3,5 cm) otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów | 230x315 | 1 |
| 2. wzmocniona osłona na stół MAYO | 79x145 | 1 |
| 3. wzmocniona serweta na stół (owinięcie zestawu) | 150x190 | 1 |

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, zgodnie z SIWZ.

17. Czy Zamawiający dopuści, aby w poz. 4 zaoferowano wzmocniony, zestaw do operacji na kończynie spełniający wszystkie wymagania obowiązującej normy PN EN 13795 1-3 w składzie

| | | |
|---|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór o średnicy 7 cm, otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów | 230x315 | 1 |
| 2. serweta na stół | 150x190 | 1 |
| 3. osłona na kończynę | 22x75 | 1 |
| 4. taśmy samoprzylepne | 9x49 | 2 |
| 5. ręczniki chłonne | 18x25 | 4 |
| 6. wzmocniona osłona na stół MAYO | 79x145 | 1 |
| 7. wzmocniona serweta na stół (owinięcie zestawu) | 150x190 | 1 |

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, zgodnie z SIWZ.

18. Czy Zamawiający dopuści, aby w poz. 5 zaoferowano wzmocniony, zestaw do artroskopii spełniający wszystkie wymagania obowiązującej normy PN EN 13795 1-3 w składzie:

1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x320 cm, posiadający samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, z możliwością zamocowania drenów. Serweta jest wyposażona w torbę do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenu 230x320 1
2. serweta na stółk 150x190 1
3. osłona na kończynę 22x75 1
4. taśmy samoprzylepne 9x49 2
5. ręczniki chłonne 18x25 4
6. osłona na stółk MAYO 79x145 1
7. osłona na stółk - (owinięcie zestawu) 150x190 1

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, zgodnie z SIWZ.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.ocr.pl.

Zamawiający

Wojciech Machelski